

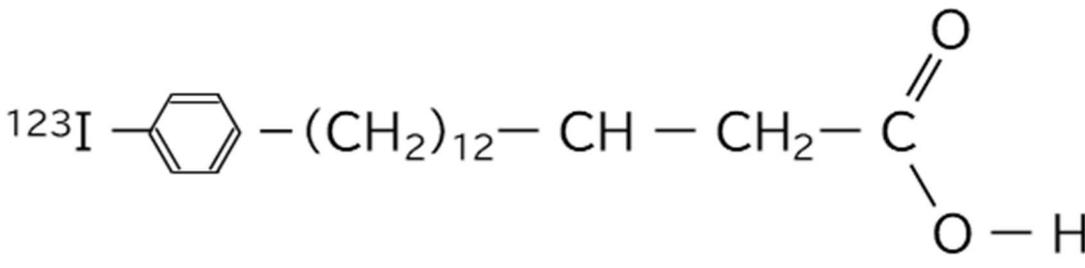
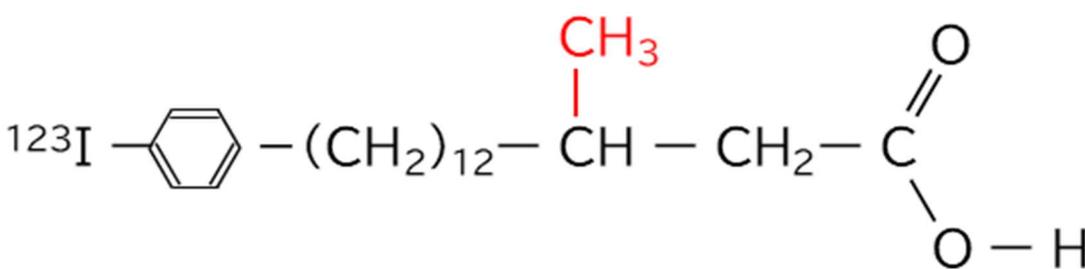
正誤表

雑誌「臨床放射線」第70巻2号（2025年3・4月号）に誤りがございました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

2025年3月

金原出版株式会社

記

頁	224
訂正箇所	図1 ^{123}I -BMIPP 構造式
誤	
正	 <p>β位の側鎖 (-CH₃) が落ちていました。</p>

以上